BIOSPECT ultra

Système expert d'analyses et traitements quantiques

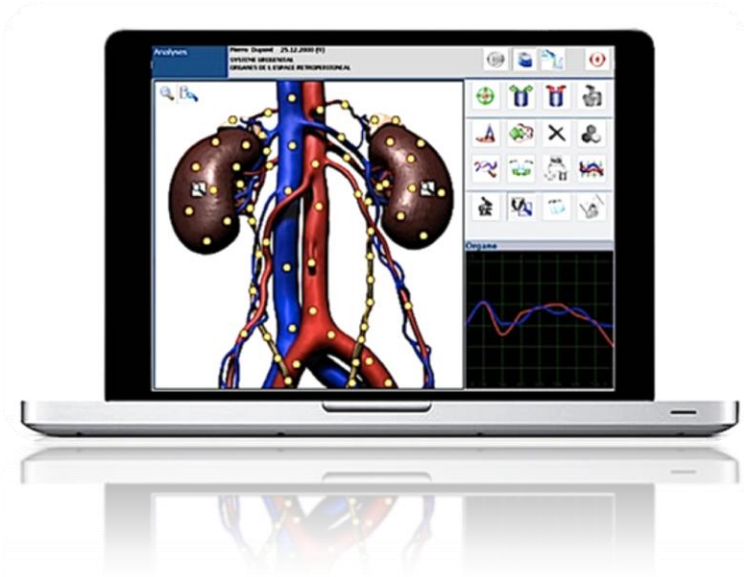

Biospect.ca, C.P. 1043, Trois-Rivières (Québec) G9A 4X0 - Canada
www.biospect.ca - info@biospect.ca - tél. 819-244-4070

Table des matières

1. PREAMBULE 4
2. FONCTIONNEMENT 5
3. LA CONSULTATION 5
4. ANALYSES / TRAITEMENTS / CONTRÔLE 6
   - 4.1 Analyses 6
   - 4.2 Traitements par bio-résonnance 7
   - 4.3 Contrôle 7
5. ANALYSES DÉTAILLÉES 7
   - 5.1 Choix des cibles 7
   - 5.2 1ère analyse - Déterminer le degré d'adaptation des organes 9
   - 5.3 2e analyse - Déterminer le terrain 10
     - a) Analyse par les courbes de structures et de fonction 10
     - b) Analyse de la communication inter-organique 11
     - c) Analyse de cohérence spectrale 11
     - d) Analyse d'entropie 12
   - 5.4 3e analyse - Analyse biochimique par NLS – Evaluation sanguine 13
6. TRAITEMENTS & CONTRÔLE 14
   - a) La Méta-thérapie (biorésonance) 14
   - b) Préparation de remèdes fréquentiels personnalisés 14
   - c) Création de remèdes fréquentiels 15
   - d) Contrôle thérapeutique par test neurovégétatif : Végéto test 15
   - e) Suivi thérapeutique : 16
7. NOTRE OFFRE 16

1. PREAMBULE

Le Biospect Ultra est une technologie automatisée et informatisée, indépendante de toute influence humaine, capable de communiquer au niveau cellulaire par l'intermédiaire de fréquences. Les anomalies fonctionnelles de l'organisme peuvent ainsi être répertoriées et corrigées en envoyant au patient les fréquences enregistrées dans la banque de données de l'appareil.

Ces premières approches technologiques furent développées par des physiciens russes à l'usage de la recherche aérospatiale, partant de ses deux principes fondamentaux :

1. le cerveau est la base d'envoi et de réception d'informations vibratoires et
2. le corps humain est un système sophistiqué de communications.

La technologie du Biospect Ultra destinée aux praticiens de la santé est issue de cette version scientifique expérimentale.

Cet appareil :

- analyse rapidement le niveau énergétique des différents organes, tissus, cellules… afin d'évaluer la fonction de chacun d'eux, ainsi que l'état de santé global du patient,
- compare les résultats de chaque patient avec les propres bases de données enregistrées dans le logiciel en fonction du sexe, de l'âge, du groupe sanguin…
- estime la meilleure action à poser afin d'éviter une dégradation de la santé,
- corrige les déséquilibres énergétiques par l'envoi au patient de fréquences spécifiques,
- analyse l'effet de diverses thérapies – médications – remèdes – aliments, etc. sur le patient.

Les fréquences électromagnétiques émises par l'appareil étant extrêmement faibles sont de nature non invasive et sans danger pour le patient et le thérapeute.

Le but de cette technologie est de compléter les autres approches thérapeutiques et non de les remplacer. L'application de cette investigation nécessite de la part de l'utilisateur une bonne connaissance en anatomie et physiologie humaine.

Le Biospect fonctionnant sur le Système d'Analyse Non linéaire (NLS), ses mesures et analyses donnent des informations sur la santé **dynamique** de l'organisme, ne pouvant en aucun cas remplacer le diagnostic du médecin.

Le Biospect Ultra est le système d'analyses et traitements de l'homéostasie le plus développé à ce jour.

Le Biospect Ultra est à l'avant garde des autres appareils de même type sur le marché, il est en constante amélioration et comprend une interface simple avec des choix clairs de fonctionnement (icônes, par systèmes ou non, automatique ou manuel, etc.). Prenez note des nombreuses fonctions, dont certaines sont uniques à notre appareil, voir la section 4.

2. FONCTIONNEMENT

L'appareil est constitué d'un casque muni de collecteurs magnétiques, d'un boîtier collecteur de signaux et d'un logiciel interface à installer sur ordinateur.

L'appareil envoie, via l'émetteur des informations électromagnétiques qui vont entrer en résonance avec les signaux propres de chaque organe. Le signal particulier de chaque organe est ainsi reçu, traité, comparé avec la base de données de l'appareil et analysé.

Le résultat de ce travail apparaît alors sur l'écran de l'opérateur sous forme de représentation imagée des organes, de symboles de couleur, de courbes et de données.

3. LA CONSULTATION

Le Biospect Ultra est employé en complément à de nombreuses thérapeutiques (ostéopathie, acupuncture, homéopathie, naturopathie, etc.). Le déroulement de la consultation dépendra donc de la spécificité de ces thérapeutiques.

Elle peut se résumer en 3 étapes :

- L'analyse du terrain des organes et tissus choisis
- Le traitement : ré-information par biorésonance, fabrication de remèdes fréquentiels
- Le contrôle : végéto test, contrôle thérapeutique, contrôle prescriptions

Elle permet d'effectuer dans une même consultation un bilan de santé énergétique complet + un traitement par biorésonance + un contrôle thérapeutique.

En pratique :

- Le patient place le casque sur sa tête
- L'opérateur ouvre la fiche patient et sélectionne les organes ou tissus qu'il souhaite tester
- Pendant l'analyse, l'appareil affiche une représentation imagée en couleur de l'organe avec des symboles permettant de déterminer l'état de fonctionnement par zone
- Lorsque l'analyse est terminée, l'appareil affiche en haut de liste les organes scannés
- L'opérateur sélectionne ensuite l'organe ou les organes sur lequel ou lesquels il souhaite approfondir l'analyse

4. ANALYSES / TRAITEMENTS / CONTRÔLE

4.1 Analyses

- **Analyse du fonctionnement :** analyse topique, 5 mesures de " fonctionnement optimal" à "fonction organique réduite"
- **Analyse spectrale :** analyse des courbes permettant de connaître les mouvements dynamiques (fonction / structure, anabolisme / catabolisme, système en réparation), au niveau du terrain correspondant aux organes ou tissus analysés
- **Evaluation du niveau pathologique :** analyse de similitude spectrale avec la base de données fréquentielles du « Biospect Ultra » (plus de 2500 fréquences).
- **Evaluation de l'état organique :** analyse de l'entropie, 7 mesures d' "ordre structurel élevé " à " état de chaos probable "
- **Analyse de l'atteinte tissulaire des organes :** (artères, veines, système lymphatique,…) permettant d'orienter la nature d'un traitement : quel terrain faut-il rétablir en priorité ?
- **Evaluation des tendances du terrain :** évaluation de la tendance d'un terrain : amélioration ou aggravation
- **Analyse biochimique NLS** : évaluation non linéaire des éléments biochimiques
- **Analyse de la structure des organes** : de l'organe à la cellule en 9 étapes automatiques
- **Analyse des points d'acupuncture** - **points de Voll**
- **Analyse par zone**
- **Analyse émotionnelle** (pack émotionnel incl.)

Cet ensemble d'analyses éclaire précisément sur l'état du terrain d'un organe ou tissu. Il permet de comprendre, anticiper et accompagner les processus dynamiques présents au sein de l'organisme afin de favoriser la meilleure santé. L'interprétation des informations requiert cependant une compréhension des différents processus d'équilibration de l'organisme (homéostasie, pathologie).

4.2 Traitements par bio-résonnance

- **Méta-thérapie :** envoi d'informations fréquentielles permettant de rééquilibrer la structure énergétique de l'organe conformément aux principes de bio résonance
- **Ré information fréquentielle : e**nvoi d'informations fréquentielles sur une matrice (eau, alcool, huiles, préparations sucrées,...) permettant au patient de recevoir un traitement sur plusieurs semaines. L'appareil possède les informations sur plus de 2500 préparations (homéopathie, phytothérapie, allopathie, compléments alimentaires,…) qu'il peut sélectionner de façon automatique.
- **Création de remèdes fréquentiels :** le « Biospect ultra » peut créer et évaluer des remèdes personnalisés correspondant à la biologie de l'organisme étudié

Ces différents protocoles de traitements permettent de traiter le terrain par l'envoi de fréquences correspondant exactement aux besoins de l'organisme étudié.

4.3 Contrôle

- **Contrôle de résonance végétative (Végéto test) :** permet de connaître par avance les effets potentiels d'un produit ou traitement sur la biologie de l'organisme.
- **Suivi thérapeutique :** via le contrôle de résonance végétative.

5. ANALYSES DÉTAILLÉES

5.1 Choix des cibles

Le Biospect permet de visualiser le niveau « énergétique/vibratoire » de l'organisme soit via les méridiens d'acupuncture - points de Voll, soit via les organes classés par système.
Les informations sont proposées sous forme d'image 2D / 3D.

Méridiens d'acupuncture :

- Main droite et gauche : méridiens intestin grêle, épithélium et parenchyme, allergies, vaisseaux sanguins, système nerveux, colon, poumons, système lymphatique et système endocrinien
- Pieds droits et gauche : méridiens reins, vessie, vésicule biliaire, peau, tissu conjonctif, estomac, articulations, foie, rate/pancréas
- Les mesures droite et gauche permettent de visualiser précisément les écarts énergétiques latéraux.

- En cliquant sur les symboles le long des tracés des méridiens, le nom de l'organe correspondant apparaît, permettant ainsi de définir ensuite la zone à traiter.

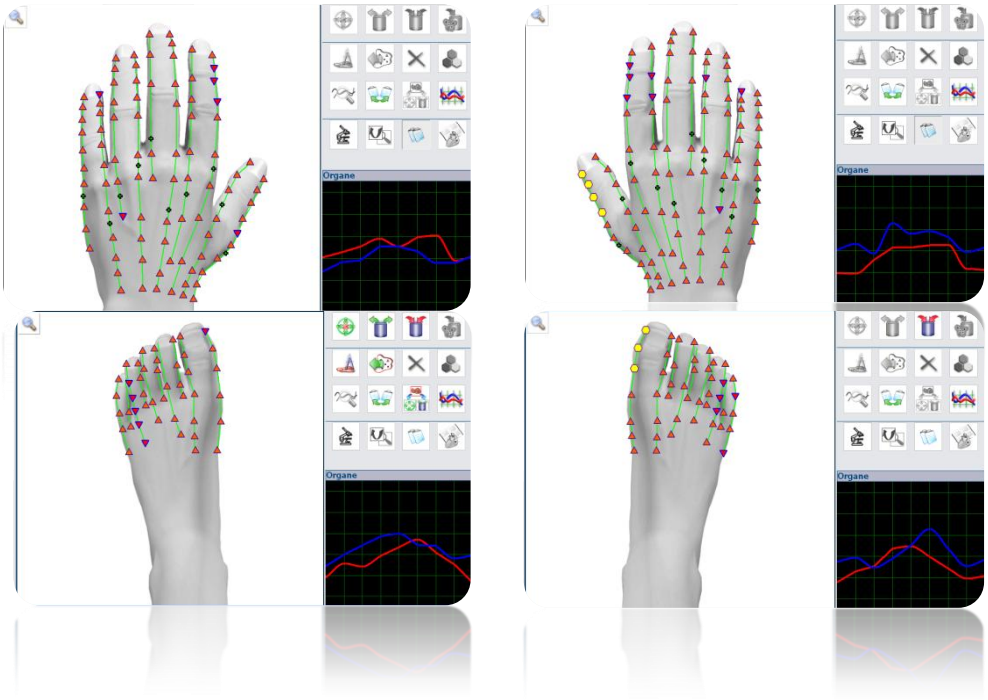

8

Organes : 320 cibles principales (organes)

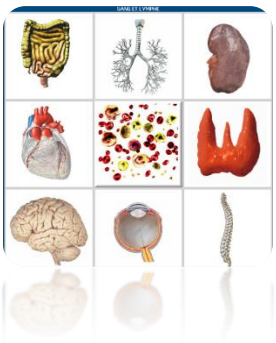

- Les organes sont classés par système (nerveux, digestif,…)
- La sélection d'un système donne accès aux organes correspondant
- Il est possible d'évaluer une zone particulière d'un organe (scan par zone)

… et plus de 2500 cibles secondaires (structure)

Après avoir sélectionné la cible principale, il est possible d'accéder aux différentes couches de la structure des organes : **fonction expert « ultrastructure »**.

Exemple ci-dessous : Thyroïde ⇨ Tissu thyroïdien ⇨ Cellule ⇨ Mitochondries ⇨ Chromosomes ⇨ Chromosome 4 ⇨ ADN ⇨ Deoxycytidine kinase ⇨ Adénine.

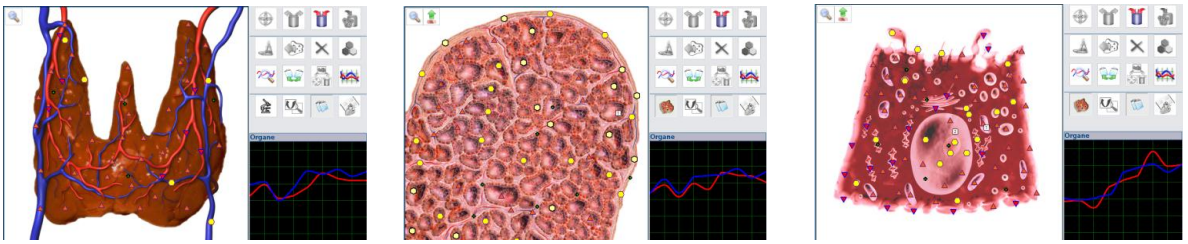

Thyroïde → Tissu thyroïdien → Cellule →

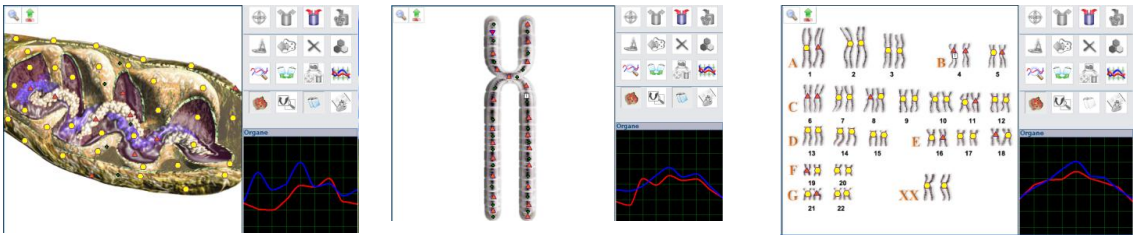

Mitochondries → Chromosomes → Chromosomes 4 →

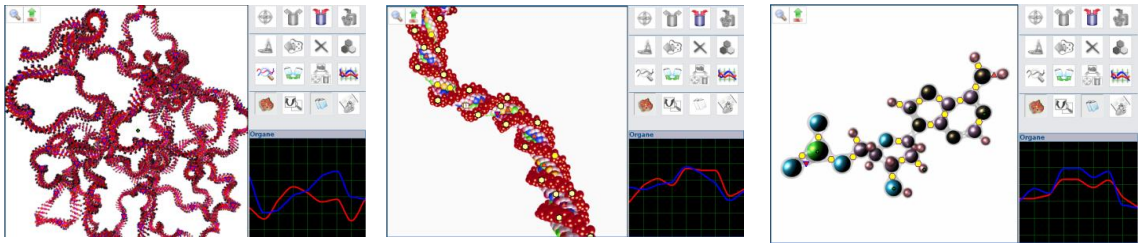

ADN → Déoxycytidine kinase → Adénine

5.2 1ère analyse - Déterminer le degré d'adaptation des organes

Mesure des processus à l'œuvre dans l'organe ou le tissu ciblé.

Le résultat est évalué sur une échelle polychromique en six points. Sur l'image de l'organe s'affichent des logos, représentant le degré de stress de l'organe et sa faculté d'adaptation selon un code de couleur allant de 1 à 6.

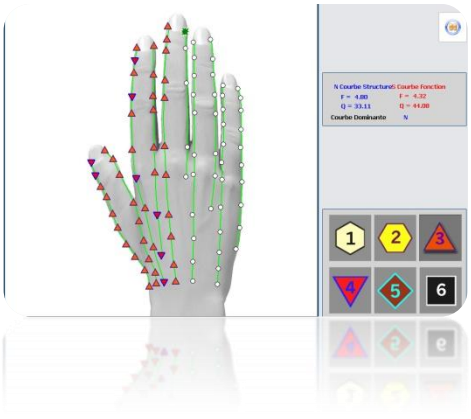

Les symboles sont gradués de 1 à 6 selon l'échelle suivante :

1 : Activité fonctionnelle latente ou Hypo fonctionnement

2 : Activité **fonctionnelle** d'adaptation optimale

3 : Caractéristiques générales au meilleur niveau, système d'adaptation en action

4 : Système d'adaptation en asthénie

5 : Altération des mécanismes d'adaptation

6 : Décompensation ⇨ condition pathologique

5.3 2e analyse - Déterminer le terrain

Mesure de l'énergie dépensée par l'organe ou le tissu ciblé pour maintenir l'homéostasie. Le résultat apparaît sous forme de courbes qui peuvent être comparées avec les fréquences de la base de données de l'appareil.

a) Analyse par les courbes de structures et de fonction

Le « Biospect ultra » considère tout système biologique comme un système cybernétique dont il mesure le « bruit ». En comparant le signal d'entrée (input : signal rouge) et le signal de sortie (output : signal bleu), il est possible d'évaluer les dynamiques (mouvements) à l'œuvre dans l'organisme. Dans un système idéal, les signaux sont similaires et joints, cela signifie qu'il n'y a pas de « bruit » dans le système.

Si ce n'est pas le cas, nous considérons que le système ne fonctionne pas correctement. Des mesures intermédiaires permettent d'évaluer précisément les processus dynamiques. Ces informations apparaissent sur un graphique dont l'amplitude va de 0 dB (point 0) à 260 dB (point 6,6).

10

Le Biospect ultra donne pour chaque organe une représentation imagée des courbes de **structure (organisation structurelle de l'organe)** et de **fonction (fonctionnement de l'organe / comment il effectue ses « tâches »).**

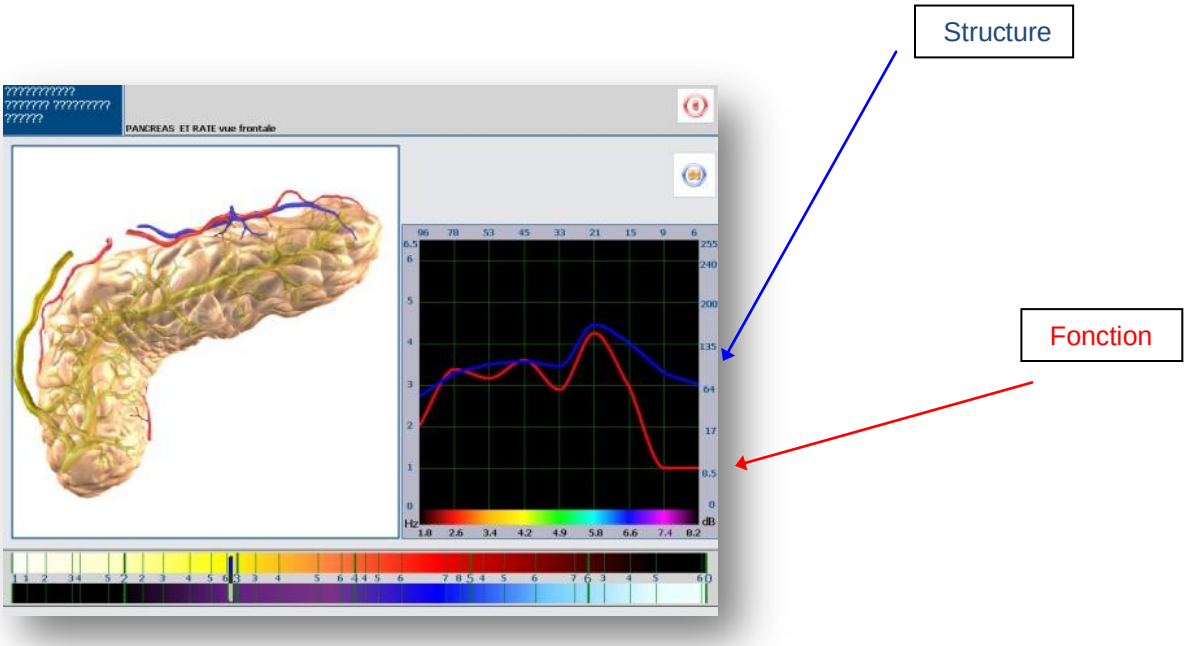

- La structure et la fonction doivent être parfaitement coordonnées
- L'éloignement de ces deux courbes signifie que la structure et la fonction de l'organe ne sont plus en syntonie, ce qui laisse supposer un dysfonctionnement susceptible de favoriser l'apparition d'une maladie
- La courbe de fonction rouge sous la courbe de structure bleue signifie que l'organe est en hypofonctionnement et vice-versa

L'analyse de ces courbes donne des informations précieuses sur les processus en cours dans l'organisme (système en réparation, décompensation, anabolisme, catabolisme, évolution, tendance,…)

b) Analyse de la communication inter-organique

Les courbes bleues et rouges nous informent également sur le niveau de communication de l'organe avec son environnement. Un organe qui fonctionne correctement communique également correctement avec son environnement

Le spectre de lecture est étalonné de 1.8 Hz a 8.2 Hz de la manière suivante

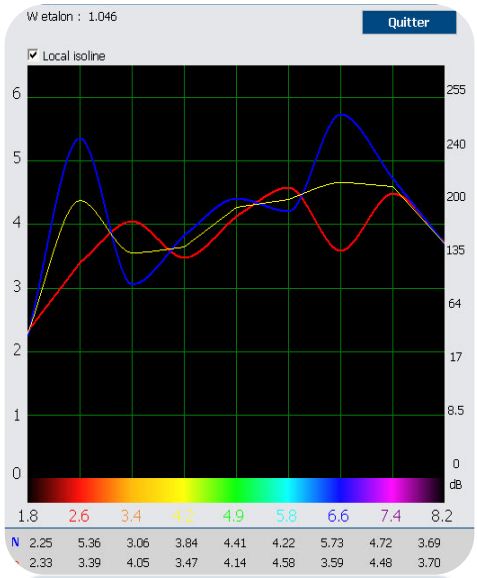

- *1.8 Hz - os et système osseux*
- *2.6 Hz - tissus grossier, articulations, valvules cardiaques*
- *2.6-3.4 Hz - tissus musculaire, muscle cardiaque*
- *3.4Hz - muscles lisses*
- *4.2 - système digestif*
- *4.9 Hz - foie et vésicule biliaire*
- *4.9-5.8 Hz -reins et organes reproductifs*
- *5.8 Hz - prostate, ovaires, rate, système lymphatique,*
- *6.6 Hz - surrénales thyroïde et bronches, système nerveux périphérique*
- *7.4 Hz - système nerveux, poumons, structure cérébrale subcorticale, cerveau,*
- *8.2 Hz - yeux, rétine, nerf optique, hémisphères cérébraux*

c) Analyse de cohérence spectrale

Le Biospect ultra possède une base de données de fréquences très complète (plus de 2500 fréquences). Elles correspondent aux signatures fréquentielles des terrains de nombreuses pathologies ainsi que de nombreux remèdes. Le Biospect ultra effectue pour chaque organe une comparaison entre les fréquences enregistrées de l'organe et celles de la base de données.

La base de données est divisée en famille :

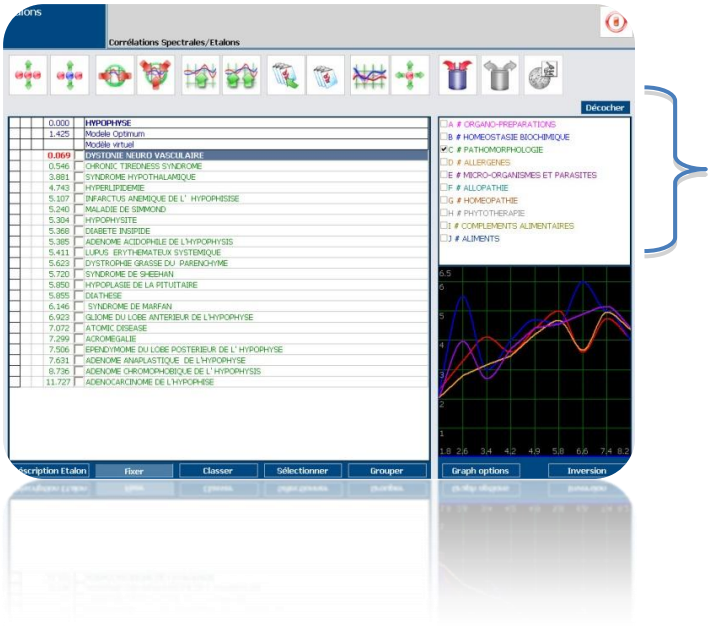

- ✓ *Organo-préparations*
- ✓ *Homéostasie biochimique*
- ✓ *Morpho pathologie*
- ✓ *Allergènes*
- ✓ *Micro-organismes et parasites*
- ✓ *Allopathie*
- ✓ *Homéopathie*
- ✓ *Phytothérapie*
- ✓ *Compléments alimentaires*
- ✓ *Aliments*
- ✓ *Fleurs de Bach*
- ✓ *Elixirs floraux*
- ✓ *Sels de Schussler*
- ✓ *Gamme nutriquantic*

Le résultat apparaît sous forme d'un classement chiffré :

- Les chiffres inférieurs à 0.1 signifient que la similitude spectrale est forte – Ils apparaissent en rouge
- Les chiffres compris entre 0.450 et 0.1 signifient que la similitude spectrale est importante, ce sont des pistes de pathologies de terrain ou pathologies chroniques
- Les chiffres compris entre 1 et 0.450 signifient que la similitude spectrale est faible, ce sont des pistes de maladies possibles
- Les chiffres supérieurs à 1 signifient qu'il n'y a pas de similitude spectrale notable

d) Analyse d'entropie

Dans un second temps, en sélectionnant la fréquence correspondant à un terrain pathologique, l'appareil donne des informations sur le degré d'entropie générale. La mesure est donnée sous forme de chiffre de 1 à 7 :

- 1 -2 Ordre structurel élevé,
- 3-4 Développement pathologique au stage pré clinique
- 5-6 Maturité du processus pathologique, ordre structurel affaiblit,
- 7 Système chaotique, installation d'un processus pathologique, ordre structurel faible

Le « Biospect ultra » informe également sur le degré d'entropie (ordre) des différents tissus.

L'information d'entropie est également donnée par type de tissus pour un organe cible: système artériel, veineux, nerveux, lymphatique, musculosquelettique…

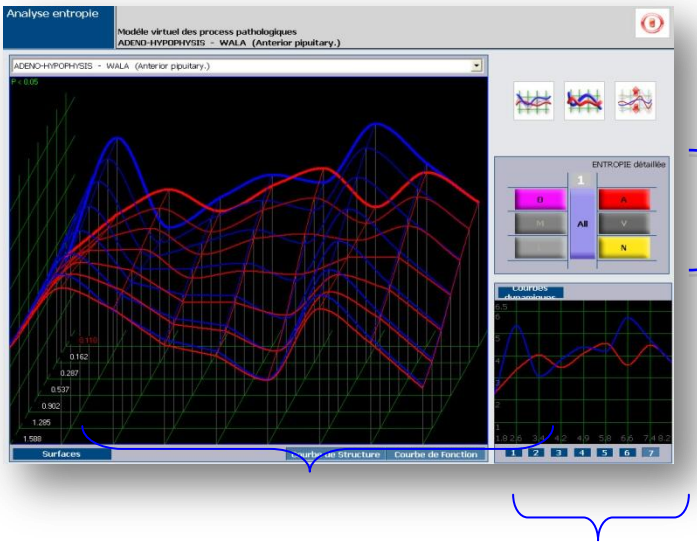

Famille de tissu ciblé

Progression schématique des divers degrés d'entropie pour la pathologie choisie

Degré d'entropie le plus proche pour la pathologie choisie (ici :7)

5.4 3e analyse - Analyse biochimique par NLS – Evaluation sanguine

Cette analyse donne des informations sur un état de carence(s), de normalité ou d'excès d'un élément biochimique. Cette analyse implique des connaissances minimum en biochimie pour l'utilisateur.

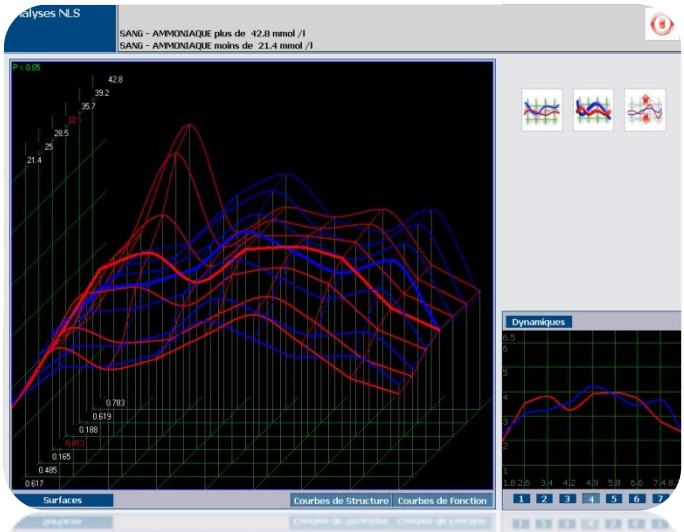
SANG - AMMONIAQUE plus de 42.8 mmol /l
SANG - AMMONIAQUE moins de 21.4 mmol /l
Dynamiques
Surfaces
Courbes de Structure
Courbes de Fonction

NB : les analyses biochimique NLS ne peuvent être systématiquement corrélées avec des analyses physiques. Leur résultat montre l'énergie dépensée par l'organisme pour trouver son équilibre. Vouloir systématiquement comparer les deux dimensions, conduit aux mêmes résultats que vouloir comparer la physique newtonienne et la physique quantique. C'est impossible car il s'agit de deux dimensions différentes, quoiqu'en interaction.

6. TRAITEMENTS & CONTRÔLE

Le « Biospect ultra » propose différents systèmes de traitements et contrôles thérapeutiques de haute technologie.

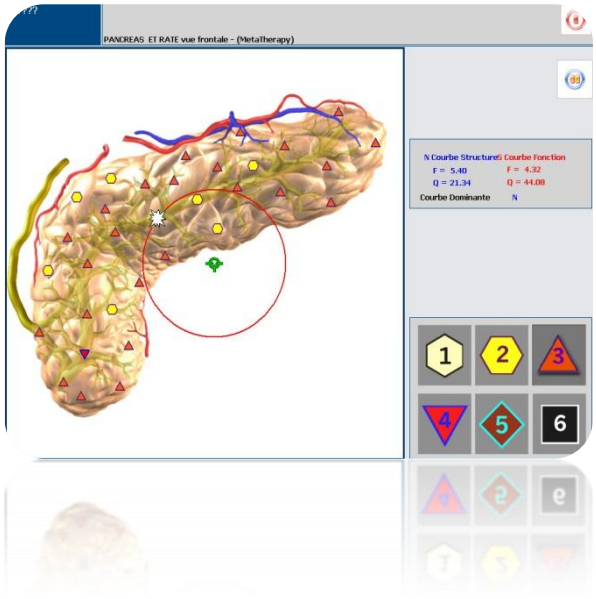

a) La Méta-thérapie (biorésonance)

- Permet de restaurer les fréquences organiques
- L'appareil envoie la fréquence électromagnétique
  Cette fréquence active la structure vibratoire de l'organe et favorise ainsi sa restructuration cellulaire et son bon fonctionnement
- 5 organes peuvent être traités dans une même séance
- La zone d'envoi de l'information vibratoire peut être précisément choisie
- Le résultat de la méta-thérapie apparaît immédiatement sur le système d'imagerie

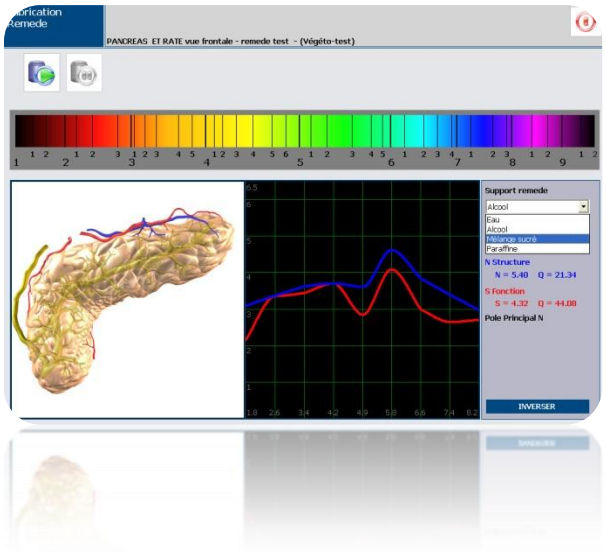

b) Préparation de remèdes fréquentiels personnalisés

L'appareil possède une base de données de fréquences dans de nombreux domaines (homéopathie, organothérapie, compléments alimentaires, allopathie, phytothérapie,…)

- Jusqu'à 5 fréquences peuvent être chargées sur un support vibratoire
- 4 supports vibratoires (eau, alcool, huiles, préparations sucrées,...) peuvent être sélectionnés selon les effets désirés
- Vérification par analyse de cohérence spectrale la bonne adéquation de l'information vibratoire thérapeutique avec la problématique de l'organe ciblé
- Les résultats potentiels du remède choisis peuvent être constatés directement et par avance sur le système d'imagerie

c) Création de remèdes fréquentiels

Le système d'analyse du Biospect peut fabriquer des remèdes fréquentiels spécialement adapté à la biologie de l'organisme étudié. Ce remède peut être envoyé à l'organisme ou chargé sur un support.

d) Contrôle thérapeutique par test neurovégétatif : Végéto test

Le système de contrôle neurovégétatif permet de connaître immédiatement les effets potentiels d'un remède sur un organe cible,

L'appareil compare la fréquence spectrale du produit avec celle de l'organe et apporte des informations sur sa capacité d'adaptation.

En outre, il peut contrôler les effets des nombreuses fréquences de sa base de données ou ceux de tout produit ou remède posés dans la chambre de résonance (allergène, fréquence lumineuse, liquide, solide, minéral, végétal…)

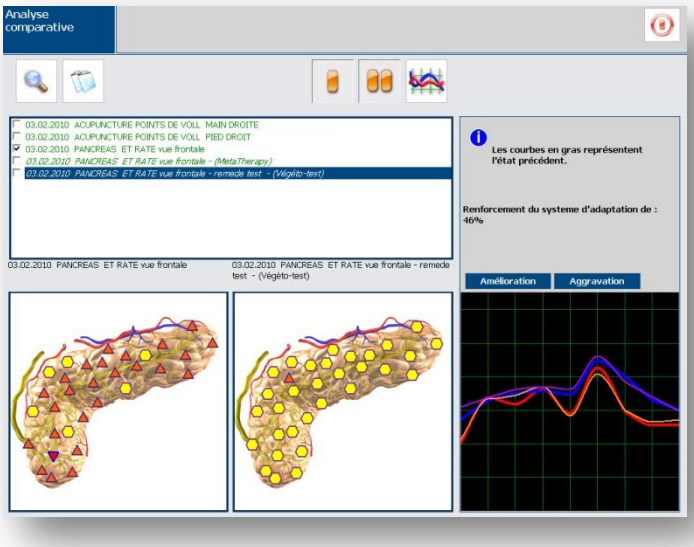
Analyse comparative
03.02.2010 ACUPUNCTURE POINTS DE VOLL MAIN DROITE
03.02.2010 ACUPUNCTURE POINTS DE VOLL PIED DROIT
03.02.2010 PANCREAS ET RATE vue frontale
03.02.2010 PANCREAS ET RATE vue frontale - (MetaTherapy)
03.02.2010 PANCREAS ET RATE vue frontale - remede test - (Végéto-test)
Les courbes en gras représentent l'état précédent.
Renforcement du systeme d'adaptation de : 46%
Amélioration
Aggravation
03.02.2010 PANCREAS ET RATE vue frontale
03.02.2010 PANCREAS ET RATE vue frontale - remede test - (Végéto-test)

1ère analyse de l'organe…

2e analyse de l'organe avec les informations du produit

e) Suivi thérapeutique :

Le système expert permet de comparer un organe entre différentes séances ou pendant une même séance. Il est ainsi possible d'effectuer un suivi thérapeutique précis.

7. NOTRE OFFRE

Offre :

Nous offrons le dernier né des appareils Biospect : le Biospect Ultra

- Notre offre comprend : l'appareil certifié CE et ses accessoires, le software en langue française ou anglaise, l'assistance installation, le s.a.v. 2 ans (sauf cordon), le manuel d'installation (cahier 1), le manuel d'utilisation (cahier 2) très complet et la mallette de rangement/transport.
- Nos tarifs sont consultables sur le site www.biospect.ca
- Nous pouvons livrer l'ordinateur portable neuf avec l'appareil installé, prêt à l'emploi, demandez nos tarifs.

Formation :

Nos formations sont basées sur l'utilisation de l'appareil versus la clinique et dispensées par des thérapeutes expérimentés

- Formation de base dispensée par des thérapeutes et Manuel d'utilisation extrêmement complet, maîtrise de toutes les fonctions, etc.
- Journées de formation et d'échanges basées principalement sur l'approfondissement des fonctions du Biospect et de la clinique.

Service après-vente :

- **2 ans pièces et main d'œuvre** (sauf cordon) à condition d'une utilisation conforme de l'appareil
- Diagnostic téléphonique
- Assistance dépannage via votre connexion internet

Ordinateur :

- L'ordinateur ne fait pas partie de la fourniture de base
- Le «Biospect ultra» peut être installé sur plusieurs ordinateurs
- Spécifications informatiques minimum :
  - Système d'exploitation Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Mac avec émulateur PC
  - CPU Pentium IV – 1.8 Ghz mini – Ram 1G mini – Carte vidéo, 16MB mini
  - Disque dur : au moins 1 GB d'espace libre – 2 ports USB – Lecteur CD Rom

Démonstration / Informations :

- Nous pouvons effectuer une démonstration de l'appareil directement sur votre ordinateur via votre ligne internet.
- Notre équipe se tient également à votre disposition pour toute information complémentaire.

NB : De nombreuses personnes nous contactent après avoir acheté un appareil à l'étranger, souvent à un prix inférieur, démunies de n'avoir ni formation ni service après-vente. En acquérant un appareil chez nous vous profitez de ces services indispensables et vous nous permettez de continuer à faire évoluer cette technologie. Merci !

Plus d'informations sur : www.biospect.ca

et

BIOSPECT.CA
135, rue Fusey, C.P. 1043
Trois-Rivières (Québec) G9A 4X0
info@biospect.ca
819-244-4070

Nous remercions M. Loïc Lechevallier (Biospect EU) pour sa précieuse contribution à l'élaboration de ce document.

© Biospect.ca 2010